

## DSKM 5. Dec. 2006

---


### Betydning af miljøprøver til epidemiologisk udredning af MRSA-udbrud på en afdeling

Lisbeth Kyndi Bergen  
Hygiejnesygeplejerske  
Amager Hospital

## Forholdsregler specielt for AH

---

- Screening ved indlæggelse:  
**ALLE**
  - Patienter med sår → podes fra sårene
  - Patienter med KAD → urin til D+R
- Isolation og podning
  - 2 plejehjem (beboer eller aflastning)

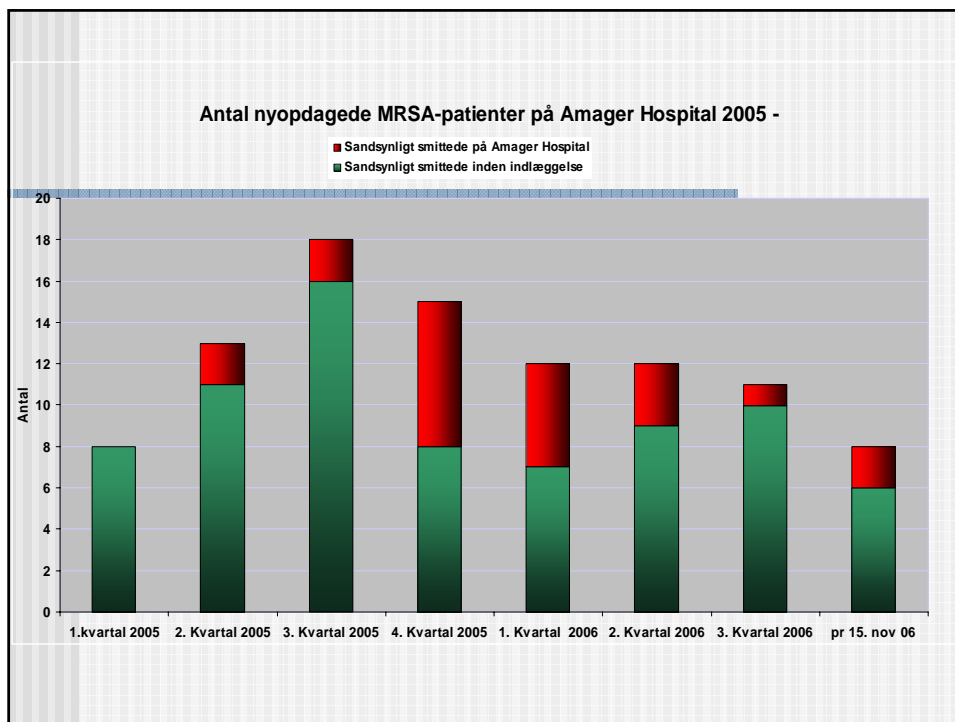

## Møder med klinikledelse d. 3. Januar 2006

- De samme stuer "går" igen
- Isolationsforholdsregler
  - Mangler værnemidler mellem jul og nytår
- Rengøring
  - Mgl. klørlugt
  - Generel snavset
  - Ingen årlig hovedrengøring


## Aftaler

- Hånddesinfektion før hver patientkontakt (lommesprit)
- Skaffe engangskitler
- Hygiejnesygeplejerske: observation i afdelingen + billeder
- Derefter videre plan
- Afvente podning af alle patienter indtil SPA-typer foreligger på de sidst smittede

## Adfærd





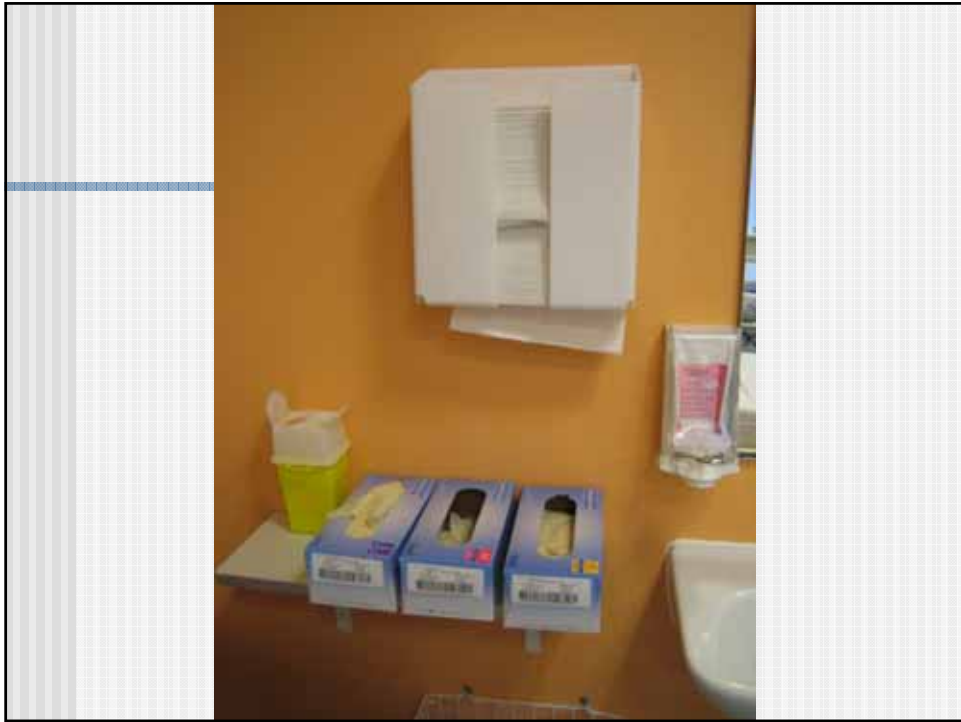

Indretning

Samtalerum – ind imellem patientstue







Medicin/blodprøvevogn







## Rengøring



## Ny plan 12. januar

---

- 19/1: stormøde for alle
- Obligatorisk undervisning
  - Generel hygiejne
  - Håndhygiejne
  - Isolation
- Oprydning
- Hovedrengøring
- Podning af alle patienter 17/1

## 3 patienter findes positive – plan udvides


- Lukke for patientindtag ca. 14 dage
  - Podning ved udskrivelse
  - Personalepodning
  - Miljøprøver
  - Udskrivelsespodning
- 
- Bekymring over kvalitet af hovedrengøring – controller kobles på

## Miljøprøver



- Stofstole



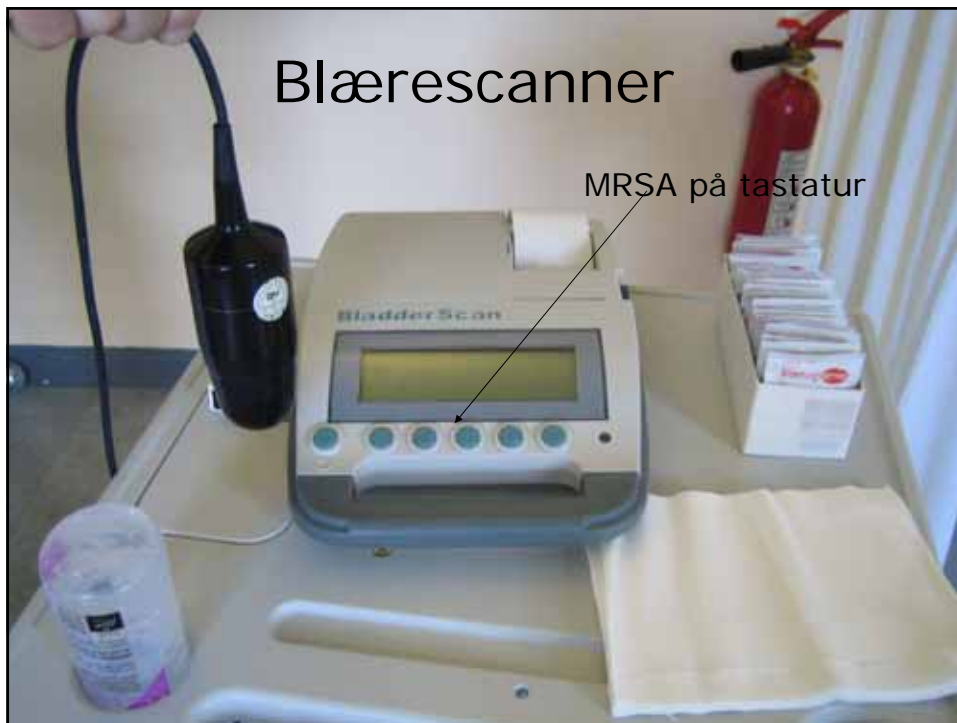





## Medio Marts

- Rengøringsforsøg med nye rengøringsklude på sengestue.
- Der findes fingeraftryk med MRSA på stuen på sengehest og vandhane
- Patienten på stuen ved siden af er isoleret pga MRSA

Hvad	CFU/cm <sup>2</sup>	Svar
EKG tastatur	12	MRSA
EKG tastatur	40	MRSA
Overvågningsudstyr	<2,5	
Fjernbetjening til TV	2,5	
Transport scop	2,5	MRSA
O <sup>2</sup> bombe	<2,5	
Transport scop	2,5	MRSA
Kørestol	12	
Stofstol, blå, sæde	12	
Stofstol, blå, sæde	12	
Stol, sæde	12	
Lænestol	12	MRSA
BT-manchet	40	MRSA
Mus til overvågningsudstyr	2,5	
Tastatur PC	12	
Tastatur	2,5	MRSA
Øre-termometer	2,5	MRSA
Saturationsmåler	<2,5	
Stol	12	MRSA